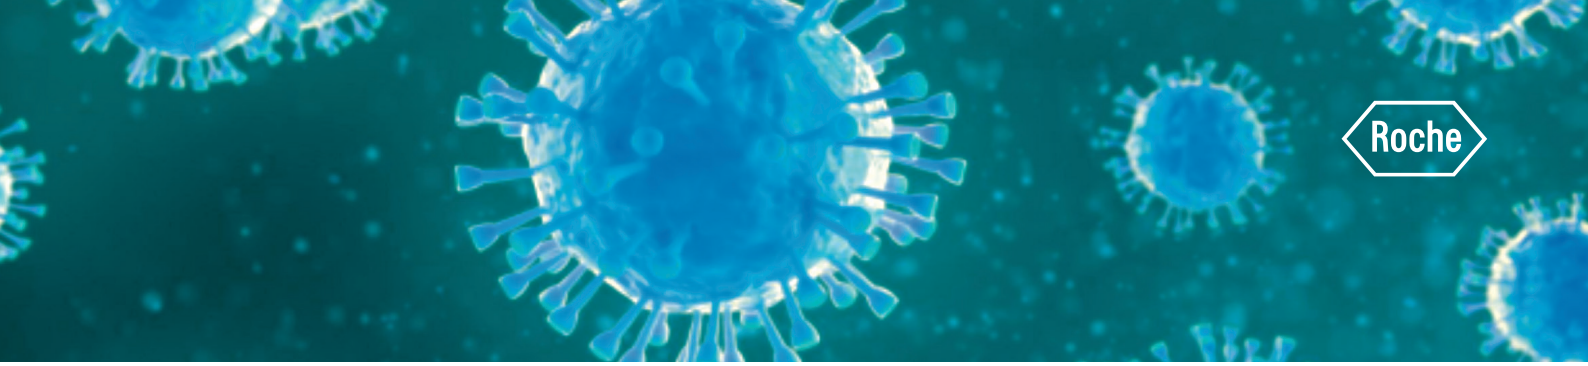

SARS-CoV-2 Antikörper Schnelltest

Zuverlässige Ergebnisse am Point-of-Care

Test Beschreibung	Immunchromatographischer In-vitro-Test zum qualitativen Nachweis von Antikörpern gegen SARS-CoV-2
Test Typ	Qualitativ
Instrument	Gerätefrei
Probenmaterial	Vollblut, Plasma oder Serum
Ziel Antigen	Nucleocapsid (N), Spike (S)
Auslesezeit	10 – 15 Minuten
Spezifität	98,65 %
Sensitivität	99,03 % (≥14 Tage nach Einsetzen der Symptome)
Lagertemperatur	2 – 30 °C
Packungsgröße	40 Tests
Anwender	Medizinisches Fachpersonal

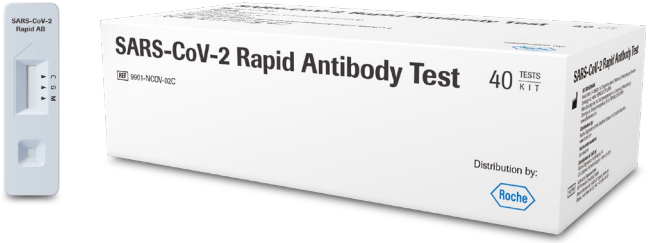

Vorteile

- ✓ Zuverlässiger Nachweis spezifischer IgG- und IgM-Antikörper gegen SARS-CoV-2
- ✓ Schnelle Ergebnisse in 10-15 Minuten
- ✓ Einfache Handhabung
- ✓ Blutentnahme aus der Fingerbeere (20 µl)
- ✓ Gebrauchsfertiges Testkit (exkl. Stechhilfen)
- ✓ Lange Haltbarkeit von bis zu 24 Monaten ohne Kühlung

Kit-Ausstattung

- ✓ Teststreifen (einzeln verpackt im Verpackungsbeutel mit Trockenmittel)
- ✓ Pufferflasche
- ✓ Kapillarröhrchen (20µl)
- ✓ Folie (kann bei Testdurchführung im Freien auf den Teststreifen geklebt werden)
- ✓ Gebrauchsanweisung
- ✓ Kurzbedienungsanleitung

Testdurchführung mit einer Blutprobe aus der Fingerspitze

3 einfache Schritte zum Ergebnis. Ablesbar nach 10-15 Minuten.

1

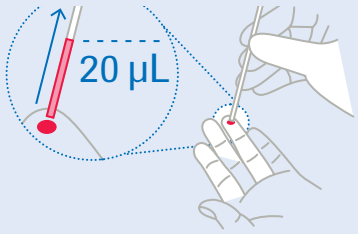

Blut aus der Fingerspitze entnehmen

Entnehmen Sie mit einem Kapillarröhrchen Kapillarvollblut, bis die schwarze Linie am Röhrchen erreicht ist. Dies entsprich einem Volumen von 20µL.

2

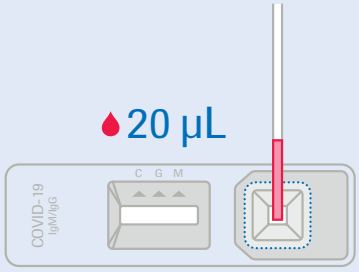

Blut auftragen

Pipettieren Sie das entnommene Kapillarvollblut in die Probenvertiefung des Teststreifens.

3



Puffer hinzugeben

Geben Sie 3 Tropfen (90µL) Pufferlösung senkrecht in die Probenvertiefung. Fügen Sie den Puffer sofort nach Auftragen der Probe hinzu.

4



Lesen Sie das Testergebnis nicht mehr ab, nachdem 15 Minuten vergangen sind. Dies kann zu einem falschen Ergebnis führen.

Testergebnis ablesen

Testergebnis:

Positiv



Positiv

Die Person hat eine adaptive Immunantwort auf SARS-CoV-2 gezeigt, was auf eine frühere Infektion hindeutet. (Positive Ergebnisse müssen in Verbindung mit der klinischen Vorgeschichte, RT-PCR Ergebnissen und anderen verfügbaren Daten interpretiert werden.)

Negativ



Negativ

Keine Antikörper gegen SARS-CoV-2 nachgewiesen. (Negative Ergebnisse schließen das Vorliegen einer SARS-CoV-2-Infektion nicht aus; dies gilt insbesondere für Personen, die mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Zum Ausschluss einer Infektion sollten bei diesen Personen Nachfolgetests mit einem molekularen Diagnostikum in Betracht gezogen werden).

Ungültig



Ungültig

Ergebnis ungültig. Verwenden Sie dieses Testergebnis nicht und führen Sie einen neuen Test durch.

Referenzen: SARS-CoV-2 Antikörper Schnelltest Packungsbeilage V02

© 2020 Roche 10/20

Roche Diagnostics GmbH
Engelhorngasse 3
1210 Wien
Österreich

www.roche.at

Haben Sie weitere Fragen?

vienna.produktmanagement@roche.com